

# 牙醫院所感染管制SOP作業 評核資料(會員宣導)

簡報製作、圖片提供：楊文甫、曾士哲醫師

意見修訂：吳迪醫師

版權所有：社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

**授權非營利的轉載利用，請保留完整授權資訊，禁止刪改內容**

# 110年度「牙醫門診加強感染管制實施方案」 修訂重點 (修訂內容尚依健保署公告為準)

1. 110年3月底前，全國院所註均需完成VPN上傳感管評核資料。
  - 1) 不合格者，6月底前進行實地訪視。
  - 2) 未上傳感管評核資料者，6月底前進行實地訪視、4月起只能申報一般診察費。

\*註：排除109年已接受感管訪查合格的院所及有醫院評鑑的醫院牙科。
2. 除前述條件將於6月底前進行實地訪視外，110年不再進行抽訪，待111年起恢復每年6-8%比例抽訪。
3. 110年SOP考評內容與109年相同，只要拍攝符合評核要求的照片，透過VPN上傳即可！
4. 110年7月起預計取消一般診察費！全體院所均需符合加強感染管制實施方案！
5. 拒絕公會輔導、屢次無法改善者：健保署將以特管辦法記點、恐無法續約、甚至健保停約！
6. 新特約院所也都將要通過訪查才能簽約！（實施時間表待確認）
7. 外展地點之感染管制實施方案尚在修訂中，通過後會即刻週知會員。

## VPN 上傳畫面-『牙醫院所感染管制評核登錄作業』

※注意事項：

1. 上傳檔案命名方式建議如下(共 5 碼)：

第 1 碼：A (硬體設備方面)或 B(軟體方面)

第 2-3 碼：評分項目編號(2 碼)，例：01、02…10、11、12

第 4 碼：評分標準 C、B、A

第 5 碼：該項需夾帶之第 N 項檔案(1 碼流水號)

舉例：A.硬體設備方面 01.適當洗手設備 C.診療區域…【檔名為 A01C1】。

2. 表格或會議記錄需以照片型式上傳。

3. 照片格式：JPG、PNG、TIF、PDF。

4. 各項目可**分別存檔**，分次完成間點選 **尚未完成上傳先行登出** 退出，下次登入時可接續自評；若須**更新資料**，可按**修正重傳**，**重新上傳檔案再存檔**，並以最後一次存檔資料列入評核。

提醒!! 各項目如按了**修正重傳**按鈕，將**自動清除**該項目已上傳的**所有檔案**，請**務必重新上傳檔案**。

5. 若自評完成且皆已夾帶相關檔案，必須按**全案已確認完成，上傳健保署**之按鈕，才算完成上傳程序，**本署系統會回復上傳成功之訊息**。

6. 若已全案上傳成功，無法再次執行上傳程序，若有需更改資料，請逕洽各分區業務組費用承辦人。

**\*詳細登錄步驟，另詳「牙醫院所感染管制評核登錄作業步驟教學」簡報檔\***

# 說明

- 勾選邏輯：
  - C一定要勾，並上傳該項要求資料
  - 符合B，則勾選C+B；
  - 符合A，則勾選C+B+A

} 分別上傳要求資料  
(即使相片可重複，該項仍須上傳)
- 記錄時間顯示以109年4月1日迄今方為有效
- (完備記錄存檔)以記錄表格起訖3個月呈現
- 「及」是皆需附；「或」可擇一附上
- 請拍攝院內實景，如有需要可於備註說明  
相片重點

# A.硬體設備方面

項目 評分標準

1.適當洗手設備 C.診療區域應設洗手台及洗手設備，並維持功能良好及周圍清潔。

檔案：照片(上限1張)

編號：A01C1



或



沒有洗手台也可以乾洗手液取代

提醒：圖片需顯示洗手台周圍清潔

# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

1. 適當洗手設備

B. 符合C，洗手水龍頭需免手觸式設計，並在周圍設置洗手液、洗手圖(遵守手部衛生五時機及六步驟)、擦手紙及垃圾桶。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：A01B1 (可與A01C1重複)



備註：龍頭裝有白色感應器，屬免手觸設計

提醒：圖片需顯示免手觸式設計，含洗手液、洗手圖、擦手紙及垃圾桶

# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

2.良好通風空調系統

C.診間有空調系統或通風良好，空調出風口須保持乾淨。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：A02C1

提醒：如有多項空調設備，  
擇一拍攝即可。



或



# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

2. 良好通風空調系統

B. 符合C定期清潔維護，有清潔紀錄本可供查詢。

檔案：表格(上限1張)

編號：A02B1

診療區環境清潔、消毒為了避免患者在診療過程中產生的血液、唾液、飛沫造成進行診療區消毒，其他區域我們也定期進行環境整潔維持。

|                  | 12/21 星期一 |    |    | 12/22 星期二 |    |    | 12/23 星期三 |    |    | 上 |
|------------------|-----------|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|---|
|                  | 上午        | 下午 | 晚上 | 上午        | 下午 | 晚上 | 上午        | 下午 | 晚上 |   |
| 診療區消毒            | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓ |
| 候診區              | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓ |
| 櫃台               | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓ |
| 感控室              | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓ |
| 其他區域             |           |    |    |           |    |    |           |    |    |   |
| 消毒鍋<br>超音波<br>產科 | ✓         | ✓  |    |           |    |    |           |    |    | ✓ |
| 檢核者              |           |    |    |           |    |    |           |    |    |   |
| 備註               | 玻璃        |    |    |           |    |    |           |    |    |   |

牙科

或

空調系統清潔維護記錄表

\* 冷氣每個月要清潔回風，每一年要記得清潔內外機

| 維護日期 |   |    | 維修保養內容 | 維護人員簽名      | 備註 |
|------|---|----|--------|-------------|----|
| 年    | 月 | 日  |        |             |    |
| 10   | 9 | 6  | 20     | 冷氣濾網清洗 x 2台 | 佳  |
| 10   | 9 | 8  | 22     | 冷氣濾網清潔 x 2台 | 萱  |
| 10   | 9 | 10 | 24     | 冷氣濾網清潔 x 2台 | 佳  |
| 10   | 9 | 12 | 19     | 冷氣濾網清洗 x 2台 | 佳  |
|      |   |    |        |             |    |
|      |   |    |        |             |    |
|      |   |    |        |             |    |
|      |   |    |        |             |    |

# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

3. 適當滅菌消毒設施

C. 診所具有滅菌器及在效期內的消毒劑，有適當空間進行器械清洗、打包、滅菌及儲存。

檔案：照片(上限4張)

編號：A03C1、A03C2



及



備註：如有效日期不易辨識，可再拍1張效期近照。

消毒液名稱及效期

續下頁

# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

3. 適當滅菌消毒設施


C. 診所具有滅菌器及在效期內的消毒劑，有適當空間進行器械清洗、打包、滅菌及儲存。

檔案：照片(上限4張)

編號：A03C3、A03C4



及

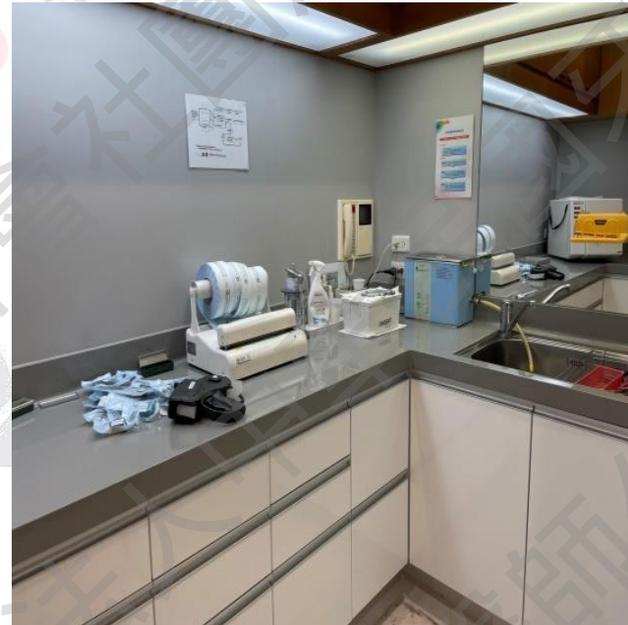

適當空間

滅菌器

# A. 硬體設備方面

項目 評分標準

3. 適當滅菌消毒設施 B. 符合C，滅菌器定期檢測功能正常（包括溫度、壓力、時間及清潔紀錄）；消毒劑定期更換，並有紀錄。

檔案：表格(上限2張)

編號：A03B1

編號：A03B2

或 及

| ★ 藥水更換  |         | 預測 (%)  | 菌 | 生物指示 |
|---|---------|---------|---|------|
| 器械消毒流程<br>★ 藥水更換<br>批分類 → 預泡 → 超音波震盪 → 清水沖洗 → 擦乾 → 打包 → 高溫高壓滅菌 (放入化學指示) | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |
|   | 12月 星期日 | 早 11:00 | ✓ | ✓    |

# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

3. 適當滅菌消毒設施

A. 符合B，具有滅菌後乾燥之滅菌器。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：A03A1 (可與A03C1重複)



# A.硬體設備方面

項目


評分標準

4.診間環境清潔

C.診間環境清潔。

檔案：照片(上限1張)

編號：A04C1

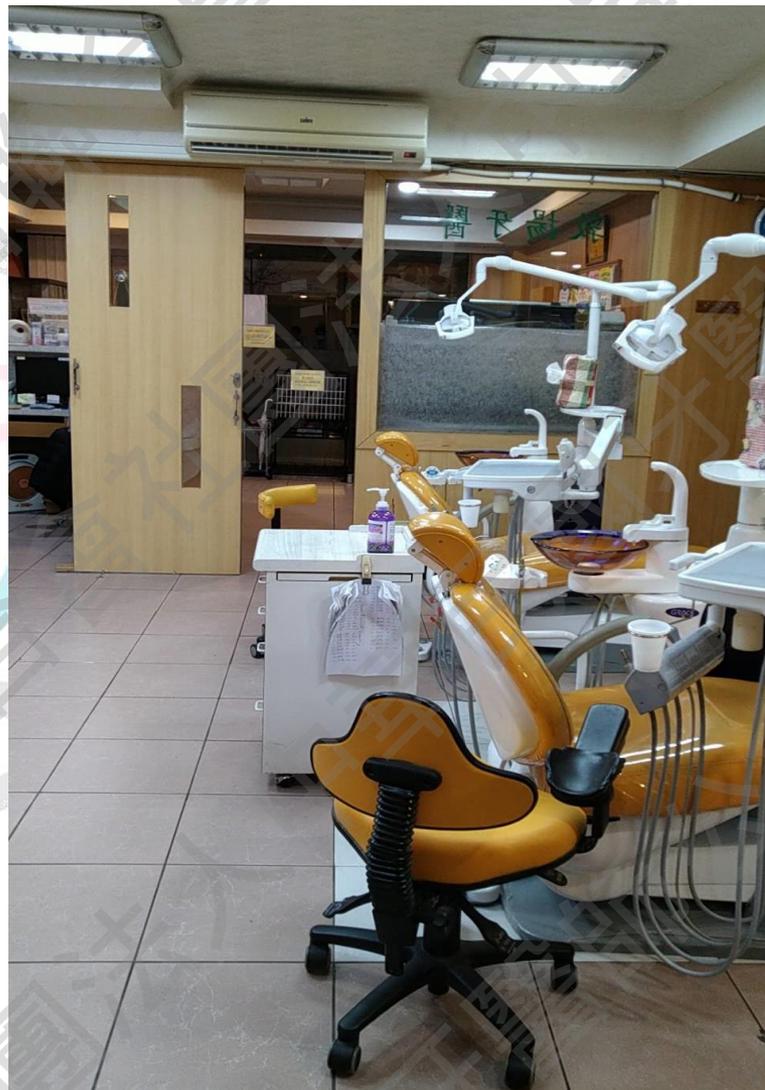

# A. 硬體設備方面

項目

評分標準

4. 診間環境清潔

B. 符合C，定期清潔並有紀錄；診療檯未使用時檯面保持淨空及乾淨。

檔案：照片及表格(上限2張)

編號：A04B1

A04B2(可與A04C1重複)

| 消毒紀錄表【環境】日期： ~   |           |    |    |          |    |    |          |    |    | 醫療廢棄物<br>回收日期 |
|--|-----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|---------------|
| 診療區環境清潔、消毒將可避免患者在診療過程中產生的血液、唾液、飛沫造成<br>進行診療區消毒，其他區域我們也定期進行環境整潔維持 |           |    |    |          |    |    |          |    |    |               |
|  | 10/5 星期一  |    |    | 10/6 星期二 |    |    | 10/9 星期三 |    |    |               |
|  | 上午        | 下午 | 晚上 | 上午       | 下午 | 晚上 | 上午       | 下午 | 晚上 |               |
| 診療區消毒  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓             |
| 候診區  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓             |
| 櫃台   | ✓         | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓             |
| 感控室  | ✓         | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓        | ✓  | ✓  | ✓             |
| 其他區域   |           |    |    |          |    |    |          |    |    |               |
| 消毒日期   | ✓         |    |    |          |    |    |          |    |    |               |
| 消毒人員   | ✓         |    |    |          |    |    |          |    |    |               |
| 檢核者  |           |    |    |          |    |    |          |    |    |               |
| 備註   | 換水、洗手台、玻璃 |    |    |          |    |    |          |    |    |               |



# A.硬體設備方面

項目

評分標準

4.診間環境清潔

A.符合B，物品依序置於櫃中，並保持清潔。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：A04A1



或



# B.軟體方面

項目

評分標準

1.完備病人預警防範措施

C.看診前詢問病人病史。

檔案：照片或表格(上限1張)

編號：B01C1

協群牙醫診所病歷表

訂位專線: 02-2311-1125

病歷號碼: 1010721

初診日期: 95年3月2日

出生日期: 37年10月2日

年齡: 37

職業: 醫師

性別: 男

身分證號碼: 1040721

住址: [redacted]

電話: [redacted]

Past History: 請打√回答下列問題, 以幫助醫師為您做最妥善的治療, 謝謝您。

心臟方面疾病  
 血液方面疾病  
 肺臟方面疾病  
 肝臟方面疾病  
 腎臟方面疾病  
 高血壓  
 糖尿病

Aspirin  
 109年 (+) Sunde  
 (-) Control

曾外傷或拔牙後出血不止  
 藥物過敏: 麻藥、匹林劑  
 磺安劑、盤尼西林、其他  
 胃腸方面疾病  
 婦女目前懷孕中  
 梅毒或其他疾病

Additional Finding  
 108.9, 20  
 321  
 2 RCF

Oral Condition:  
 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8  
 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

E D C B A | A B C D E  
 E D C B A | A B C D E

或

依日期/依科別 請點選(預設3年)  
 起... 1010721 迄... 1040721

\*\*\*病患所有看診記錄\*\*\*  
 1040721 (門) 口腔 曾建福  
 1040714 (門) 口腔 曾建福  
 1040400 (門) 口腔 曾建福  
 1040403 (門) 口腔 曾建福

| ICD-9 病史                            | ICD-9 診斷名稱                             | ICD-10 主對應 | ICD-10 診斷                        |
|-------------------------------------|--|------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 522.5 Periapical Abscess Without Sinus | K047       | Periapical abscess without sinus |
| <input type="checkbox"/>            | 520.6 Disturbances In Tooth Eruption   | K010       | Embedded teeth                   |
| <input type="checkbox"/>            | 520.6 Disturbances In Tooth Eruption   | K011       | Impacted teeth                   |
| <input type="checkbox"/>            | 520.6 Disturbances In Tooth Eruption   | K006       | Disturbances in tooth eruption   |

評估 A #48 Disturbances In Tooth Eruption; vertical impaction of #48

計劃 P 1. Well explain the surgical risks and complications (including PSA, MSA Great palatine N, inferior alveolar nerve injury, lingual nerve injury, pain, swelling,

藥品名稱 處方劑量 使用單位 頻率 健保主動 自費 厚碼 途徑 用藥指示

提醒：上傳評核資料，可不必遮蓋加碼

# B.軟體方面

項目


評分標準

1.完備病人預警防範措施

B.符合C，詢問病人詳細全身病史、傳染病史及TOCC(旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster))，並完整登載病歷首頁。

檔案：照片或表格(上限**1**張)

編號：B01B1

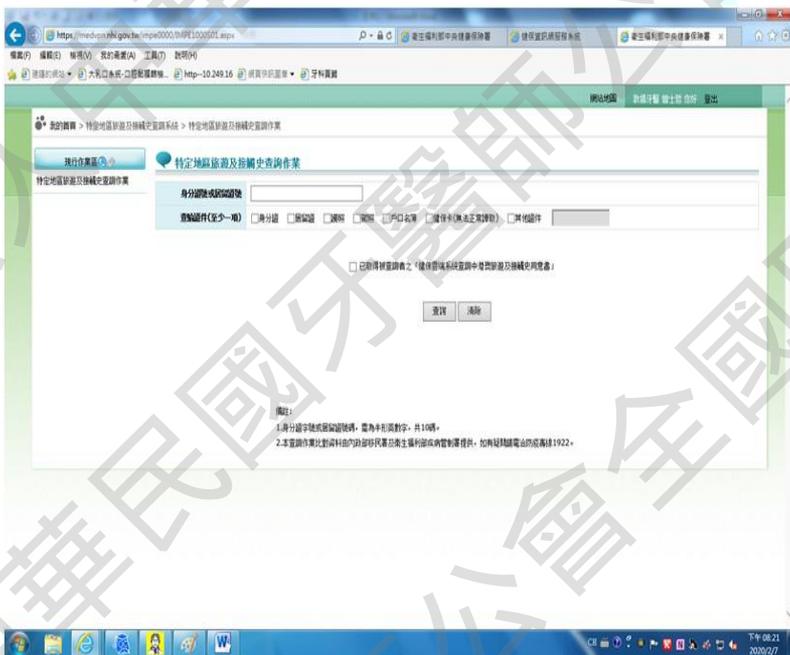

或

可點熱成填寫病歷號

### 協群牙醫診所-病人TOCC評估表(防疫聲明書)

■請掛號人員協助病人填寫以下資料，如有前五項情形，請立即通知醫師協助病人檢診作業。  
請將此表黏貼或夾附於病歷中。

病患姓名：\_\_\_\_\_ 額溫：\_\_\_\_\_ 耳溫：\_\_\_\_\_ 額溫與耳溫僅作參考

一、您最近14天內是否有以下症狀：  
發燒 (≥38°C) 【必須符合】  
咳嗽 流鼻水 鼻塞 喉嚨痛 肌肉痠痛 頭痛 極度疲倦感  
其他 \_\_\_\_\_ 無

二、您於就診前14天內旅遊史 (Travel)：  
有；回國日期：\_\_\_\_\_ 地點：\_\_\_\_\_ 【必須】 無

三、職業史 (Occupation)：  
醫事機構工作者 禽畜販賣業者  
航空服務業工作者 其他 \_\_\_\_\_ 無

四、接觸史 (Contact)：  
發燒或類流感症狀的患者接觸 禽鳥類接觸如雞、鴨等  
畜類接觸：如豬、貓、狗等 其他 \_\_\_\_\_ 無

五、群聚史 (Cluster)：近期有與同棲親友、同學、同事等及非接觸類症狀  
有，請繼續填寫：  
家人也有發燒或類流感症狀 朋友也有發燒或類流感症狀  
同事也有發燒或類流感症狀 其他 \_\_\_\_\_ 無

六、其他您認為相關應告知的狀況：(例如接觸到家人或同事14天內自中國返台...等)  
有，請繼續填寫：\_\_\_\_\_ 無

七、備註：\_\_\_\_\_

※配合防疫人人有責，本人對上述問題均據實填寫。

填寫人簽名：\_\_\_\_\_ 填寫日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## B.軟體方面

項目

評分標準

1.完備病人預警防範  
措施

A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B01A1 公筷母匙



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

1.完備病人預警防範措施

A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B01A2 單一劑量



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

1.完備病人預警防範措施

A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。

檔案：照片(上限3張)

編號：B01A3單一流程



以1張全景圖顯示器械處理空間單一流線

## B.軟體方面

項目

評分標準

1.完備病人預警防範措施

A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。

檔案：照片(上限3張)

編號：B01A3、B01A4單一流程



及



**器械處理空間單一流線**

## B.軟體方面

項目

評分標準

1.完備病人預警防範措施

A.符合B，並依感染管制原則如「公筷母匙」、「單一劑量」、「單一流程」等執行看診。

檔案：照片(上限3張)

編號：B01A3單一流程



或



呈現作業動線流程，希望看診過程不要交叉感染或汙染其他器材，將治療流程所用器械依序排開，用一張照片表現即可。

## B.軟體方面

項目

評分標準

2.適當個人防護措施

C.牙醫師看診及牙醫助理人員跟診時穿戴口罩、手套及清潔之工作服；不可使用同一雙手套照護不同病人，且穿脫手套時確實執行手部衛生。

檔案：照片(上限2張)

編號：B02C1

編號：B02C1、B02C2



或



及



## B.軟體方面

項目

評分標準

2.適當個人防護措施

B.符合C，視狀況穿戴面罩或眼罩。

檔案：照片(上限2張)

編號：B02B1



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

2.適當個人防護措施

B.符合C，視狀況穿戴面罩或眼罩。

檔案：照片(上限2張)

編號：B02B1、B02B2



及



## B.軟體方面

項目

評分標準

2.適當個人防護措施

A.符合B，並依感染管制原則「減少飛沫氣霧」執行看診。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B02A1

提醒：可減少氣沫飛霧之裝置  
如：密閉式工作箱→符合A



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

3.開診前治療台消毒  
措施

C.治療台擦拭清潔，管路出水 $\equiv$ 2分鐘，痰盂水槽流水 $\equiv$ 3分鐘，  
抽吸管以新鮮泡製0.005~0.02%漂白水(NaOCl) 或2.0%沖洗用  
戊二醛溶液(glutaraldehyde)或稀釋之碘仿溶液  
10%)(iodophors)或合格管路消毒液沖洗管路 $\equiv$ 3分鐘。

檔案：照片(上限2張)

編號：B03C1

編號：B03C1、B03C2



或



及



## B.軟體方面

| 項目           | 評分標準                                 |
|--------------|--------------------------------------|
| 3.開診前治療台消毒措施 | B.符合C，不易消毒擦拭處(如把手、頭枕、開關按鈕等)，以覆蓋物覆蓋之。 |

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B03B1



# B.軟體方面

項目

評分標準

3.開診前治療台消毒措施

A.符合B，完備紀錄存檔。

檔案：照片(上限2張) 編號：B03A1、B03A2



## B.軟體方面

項目

評分標準

4.門診結束後治療台  
消毒措施 (要2張)

C.治療台擦拭清潔，管路消毒放水放氣，清洗濾網。

檔案：照片(上限2張)

編號：B04C1、B04C2



及



## B.軟體方面

項目

評分標準

4.門診結束後治療台  
消毒措施

B.符合C，診所定期全員宣導及遵循。

檔案：照片或表格(上限1張)

編號：B04B1



# B.軟體方面

項目

評分標準


4.門診結束後治療台消毒措施

A.符合B，完備紀錄存檔。

檔案：照片或表格(上限2張)

編號：B04A1、B04A2

編號：B04A1、B04A2

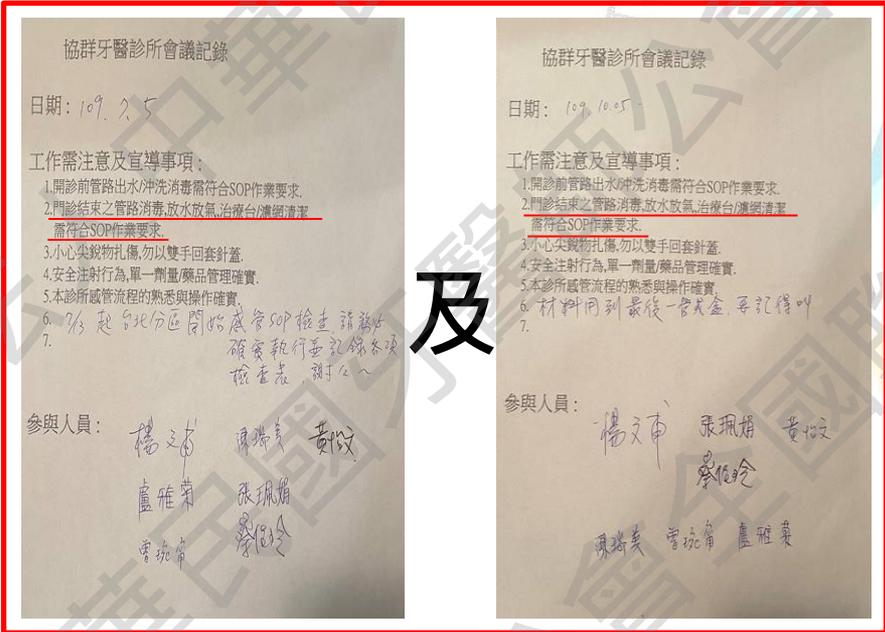

或



及

(修訂內容尚依健保署公告為準)

# B.軟體方面

項目


評分標準

5.完善廢棄物處置

C.有合格清運機構清理廢棄物及冷藏設施。(要2張)

檔案：照片及表格(上限2張)  
編號：B05C1、B05C2

提醒：如以一般家用冰箱作為廢棄物專用冰箱，請開啟冰箱門拍攝

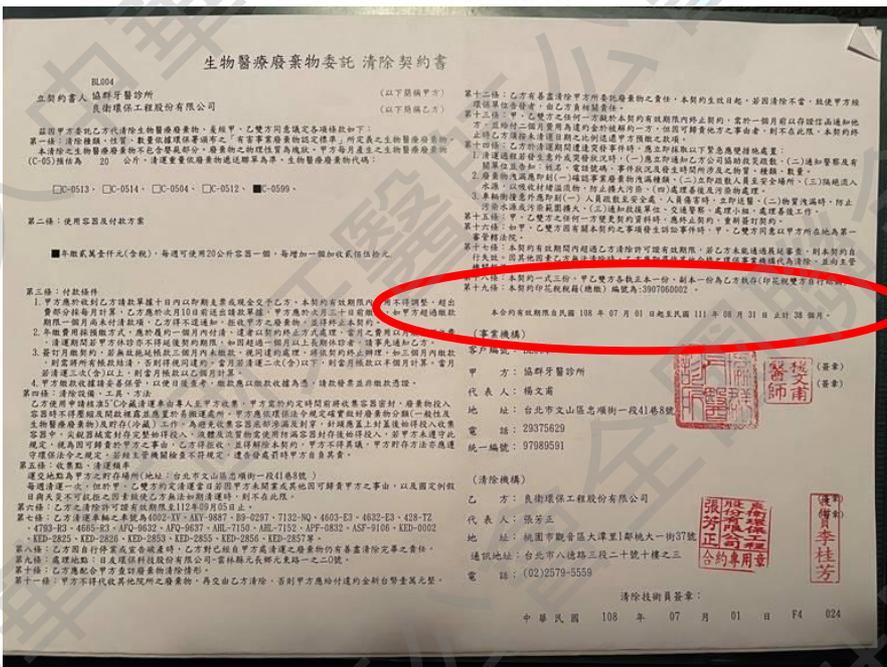

及



## B.軟體方面

項目

評分標準

5.完善廢棄物處置

B.符合C·醫療廢棄物與毒性廢棄物依法分類、貯存與處理。

檔案：照片(上限1張)

編號：B05B1

提醒：醫療廢棄物垃圾桶



或




# B.軟體方面

項目 評分標準

5.完善廢棄物處置 A.符合B，備有廢棄物詳細清運紀錄。(要2張，3個月區間)

檔案：表格(上限2張)

編號：B05A1、B05A2 (標示日期在中段)

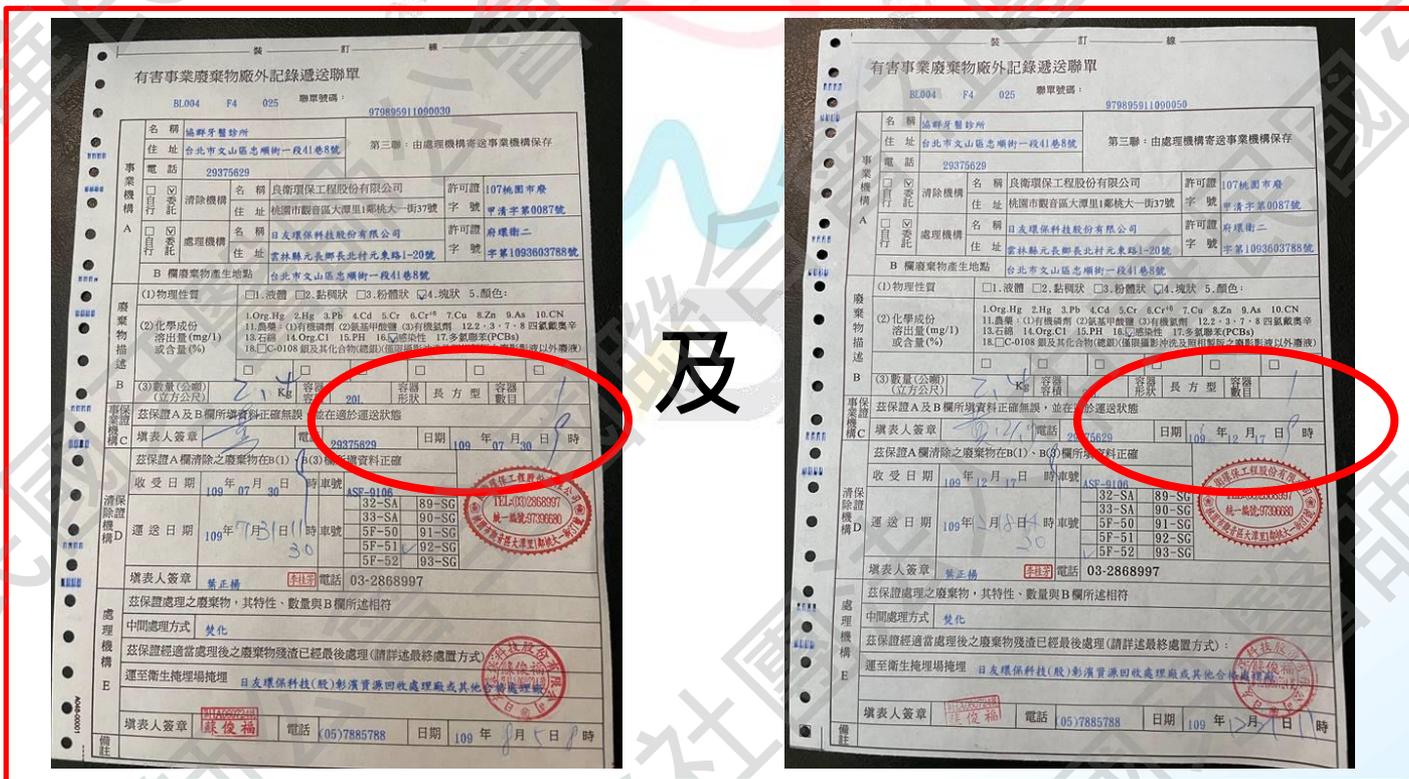

(修訂內容尚依健保署公告為準)

## B.軟體方面

項目

評分標準

6.意外尖銳物扎傷處理流程制訂

C.制訂診所防範尖銳物扎傷計畫及處理流程。

檔案：照片或表格(上限1張)

編號：B06C1



或



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

6.意外尖銳物扎傷處理  
流程制訂

B.符合C，診所定期全員宣導。

檔案：照片或會議紀錄(上限1張)

編號：B06B1



# B.軟體方面

項目 評分標準

6.意外尖銳物扎傷處理流程制訂 A.符合B，完備紀錄存檔。

檔案：表格或會議紀錄(上限2張)  
 編號：B06A1

3-2. 員工扎傷通報單 (參考格式)

| 填表單位   | 填表日期   | 年 月 日  | 編號  |
|--------|--|--|---|
| 個案基本資料 | 一、姓名 _____ 職稱 _____ 單位別/電話 _____   |  |   |
|        | 性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期 _____ 服務年資 _____  |  |   |
| 發生時間   | 二、污染來源： <input type="checkbox"/> 來源不明 <input type="checkbox"/> 其他 _____  |  |   |
|        | 年 月 日<br>時 分   | 發生地點<br><input type="checkbox"/> 職場內<br><input type="checkbox"/> 職場外 | 污染源種類<br><input type="checkbox"/> 一般注射針器 <input type="checkbox"/> 破皮針<br><input type="checkbox"/> 縫針、刀片 <input type="checkbox"/> 靜脈管置針<br><input type="checkbox"/> 血糖測試針 <input type="checkbox"/> 採血尖銳物<br><input type="checkbox"/> 外科器械<br><input type="checkbox"/> 玻璃片 <input type="checkbox"/> 血液<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 事件類別   | 需時情況<br><input type="checkbox"/> 針頭回春未對準皮數碼 <input type="checkbox"/> 清理或清除用物時 <input type="checkbox"/> 針頭彎曲或折斷<br><input type="checkbox"/> 廢棄針頭收集盒過滿扎傷 <input type="checkbox"/> 尖銳針器隱藏其他物品中 <input type="checkbox"/> 注射/加藥時<br><input type="checkbox"/> 病人躁動 <input type="checkbox"/> 解開器具配盤時/清洗用物時 <input type="checkbox"/> 尖銳針器突然掉落 <input type="checkbox"/> 藥液病人回流中<br><input type="checkbox"/> 抽血時 <input type="checkbox"/> 手衝中 <input type="checkbox"/> 其他：_____          |  |   |
|        | 行政管埋<br><input type="checkbox"/> 工作人員管理問題 <input type="checkbox"/> 環境設備管理問題 <input type="checkbox"/> 作業流程設計問題<br><input type="checkbox"/> 其他，說明：_____  |  |   |
| 發生原因   | <input type="checkbox"/> 環境傷害因素 <input type="checkbox"/> 設施/設備因素 <input type="checkbox"/> 人為疏失 <input type="checkbox"/> 技術不良<br><input type="checkbox"/> 其他因素：_____  |  |   |
| 發生經過   | 描述此事件經過：<br><input type="checkbox"/> 扎傷部位及深度(敘述)：_____<br><input type="checkbox"/> 扎傷物品已污染： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 未知<br><input type="checkbox"/> 扎傷次數： <input type="radio"/> 首次 <input type="radio"/> 曾扎傷過，第 _____ 次<br><input type="checkbox"/> 工作中戴手套： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br><input type="checkbox"/> 感染源是否為 HIV 高危險群： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 未知 |  |   |

或

6月、10月執行各級社區  
 防範針扎及意外針扎處理流程課程

|       |   |
|-------|---|
| 課程時間  | 109年6月20日   |
| 課程地點  | 診所  |
| 指導人員  | Dr.   |
| 參與人員  | Dr. 佳琳、萱  |
| 意見與回饋 | 109 1-6月無針扎。<br>1. 宣導針扎緊急處理流程。<br>2. 沒有用完的麻藥丟棄<br>要丟棄     |
| 課程時間  | 109年9月26日   |
| 課程地點  | 診所  |
| 指導人員  | Dr.   |
| 參與人員  | Dr. 佳琳、萱  |
| 意見與回饋 | 109. 6-9月無針扎。<br>1. 宣導針扎緊急流程。<br>2. 沒有用完的麻藥丟棄至<br>標藥物小藍桶。 |
| 課程時間  | 109年12月19日  |
| 課程地點  | 診所  |
| 指導人員  | Dr.   |
| 參與人員  | Dr. 佳琳、萱  |
| 意見與回饋 | 109. 9月-12月無發生針扎。<br>1. 宣導防範針扎及緊急處理流程。<br>2. 藍桶1/3滿就要倒掉。  |

## B.軟體方面

項目

評分標準

7.器械浸泡消毒


C.選擇適當消毒劑及記錄有效期限。

檔案：照片(上限2張)

編號：B07C1、B07C2(可與A03C1、A03C2重複)



及

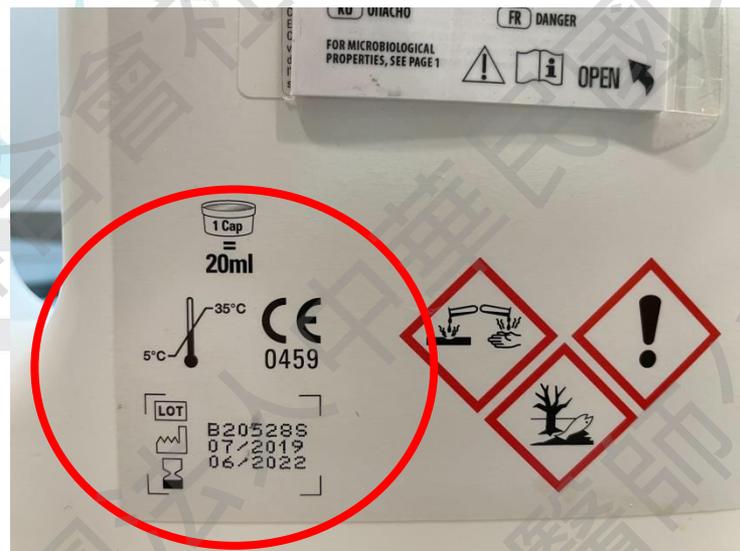

備註：如有效日期不易辨識，  
可再拍1張效期近照。

## B.軟體方面

項目

評分標準

7.器械浸泡消毒

B.符合C，消毒劑置於固定容器及加蓋，並覆蓋器械。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B07B1

提醒：有蓋的泡消容器皆可



## B.軟體方面

| 項目       | 評分標準             |
|----------|------------------|
| 7.器械浸泡消毒 | A.符合B. 記錄器械浸泡時間。 |

檔案：表格 (上限**1**張)

編號：B07A1

**器械消毒滅菌監測記錄表**

每日器械消毒流程  
器械分類處理→沖洗→浸泡→超音波震盪→清水洗淨→乾燥器械→器械封包→消毒鍋(請放入化學指示劑)→紀錄

| 程序       | Day  | 12月28日<br>(星期一)  | 12月29日<br>(星期二)  | 12月30日<br>(星期三)  | 12月31日<br>(星期四)  | 1月1日<br>(星期五)  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 操作者      |  | 佳  | 佳  | 佳  | 佳  | ×  |
| 處理時間     | 時 分  |  |  |  |  |  |
| 穿戴個人防護裝備 |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 更換消毒液    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                     | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                     |
| 分類處理     |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 沖洗       |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 浸泡       | 120分鐘  | 120分鐘  | 120分鐘  | 120分鐘  | 120分鐘  | 120分鐘  |
| 超音波震盪    | 10分鐘   | 10分鐘   | 10分鐘   | 10分鐘   | 10分鐘   | 10分鐘   |
| 清水洗淨     |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 乾燥器械     |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 器械封包     |  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 進鍋時間     |  | 19時00分   | 20時30分   | 20時50分   | 20時50分   | 20時50分   |
| 消毒鍋溫度    |  | 121°C  | 121°C  | 121°C  | 121°C  | 121°C / 134°C  |
| 化學指示劑判讀  |  | 3M 1250 Type 4 121-134°C (250-273°F)<br>Line turns as dark or darker than color match when processed | 3M 1250 Type 4 121-134°C (250-273°F)<br>Line turns as dark or darker than color match when processed | 3M 1250 Type 4 121-134°C (250-273°F)<br>Line turns as dark or darker than color match when processed | 3M 1250 Type 4 121-134°C (250-273°F)<br>Line turns as dark or darker than color match when processed | 3M 1250 Type 4 121-134°C (250-273°F)<br>Line turns as dark or darker than color match when processed |
| 指示劑變色    |  | 否  | 否  | 否  | 否  | 否  |
| 器械儲存     |  | 否  | 否  | 否  | 否  | 否  |

## B.軟體方面

| 項目           | 評分標準                   |
|--------------|------------------------|
| 8.重要醫療物品器械滅菌 | C.器械清洗打包後，進鍋滅菌並標示滅菌日期。 |

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B08C1

提醒：標示日期，方式不拘，  
但不要弄破紙袋或妨礙蒸氣滲透



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

8.重要醫療物品器械  
滅菌

B.符合C·化學指示劑監測，並完整紀錄。

檔案：照片及表格(上限2張)

編號：B08B1、B08B2



及

| 【假水更換】 | 12/28      | 生物指示劑結果   | 實驗組        | 負有反應 | 執行者 | 檢核者 |    |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
|--------|------------|-----------|------------|------|-----|-----|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 處理時段   | 12月8日 星期一  | 預熱 (___%) | 粗發波 (___%) | 清水沖洗 | 漂乾  | 打包  | 高壓 | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 12月29日 星期二 | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 12月30日 星期三 | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 12月31日 星期四 | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月1日 星期五   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月2日 星期六   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月3日 星期日   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月4日 星期一   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月5日 星期二   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月6日 星期三   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月7日 星期四   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月8日 星期五   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月9日 星期六   | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月10日 星期日  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月11日 星期一  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月12日 星期二  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月13日 星期三  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月14日 星期四  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月15日 星期五  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月16日 星期六  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月17日 星期日  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月18日 星期一  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月19日 星期二  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月20日 星期三  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月21日 星期四  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月22日 星期五  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月23日 星期六  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月24日 星期日  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月25日 星期一  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月26日 星期二  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月27日 星期三  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月28日 星期四  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月29日 星期五  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月30日 星期六  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |
| 日期     | 1月31日 星期日  | ✓         | ✓          | ✓    | ✓   | ✓   | ✓  | 121C/15min | 134C/3min |

## B.軟體方面

項目

評分標準

8.重要醫療物品器械  
滅菌

A.符合B，每週至少一次生物指示劑監測及消毒鍋檢測，並完整紀錄。

檔案：照片及表格(上限2張)

編號：B08A1、B08A2( B08A2可與B08B2相同)



及

| 【集水匣換】 |   | 日期 | 時間 | 生物指示劑結果 | 實驗組         | 執行者 | 檢核者 |
|--------|---|----|----|---------|-------------|-----|-----|
| 12     | 月 | 28 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 12     | 月 | 29 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 12     | 月 | 30 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 1  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 2  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 3  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 4  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 5  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 6  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 7  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 8  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 9  | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 10 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 11 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 12 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 13 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 14 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 15 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 16 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 17 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 18 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 19 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 20 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 21 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 22 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 23 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 24 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 25 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 26 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 27 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 28 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 29 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |
| 1      | 月 | 30 | 日  | 早       | 13:40/3 min | 林君  |     |

## B.軟體方面

項目

評分標準

9.滅菌後器械貯存

C.滅菌後器械應放置乾淨、乾燥且有覆蓋物之處，並依效期先後使用。

檔案：照片(上限1張)

編號：B09C1



或



## B.軟體方面

項目

評分標準

9.滅菌後器械貯存

B.符合C，器械貯存不超過有效期限(打包袋器械貯存不超過一個月，其餘一週為限)。

檔案：照片(上限**1**張)

編號：B09B1



或



# B.軟體方面

項目 評分標準

9.滅菌後器械貯存 A.符合B，器械定期清點，若包裝破損或過期器械，需重新清洗打包滅菌，並有紀錄可查詢。

檔案：表格(上限1張)

編號：B09A1

每月第二個星期六執行  
B-9 消毒包裝破損或過期重新消毒記錄表

| Day          | 程序   | 消毒包裝袋 | 化學指示劑判讀  | 變色                              | 重消紀錄       |
|--------------|------|-------|--|---------------------------------|------------|
| 5月1日 (星期一)   | 包裝破損 | 1     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 5.9   |
|              | 過期器械 | 0     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 6.9                        |            |
| 6月12日 (星期六)  | 包裝破損 | 0     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 6.13  |
|              | 過期器械 | 3     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 7.13                       |            |
| 7月11日 (星期日)  | 包裝破損 | 0     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 7.11  |
|              | 過期器械 | 3     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 8.11                       |            |
| 8月15日 (星期三)  | 包裝破損 | 0     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 8.15  |
|              | 過期器械 | 2     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 9.15                       |            |
| 9月12日 (星期日)  | 包裝破損 | 1     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 9.12  |
|              | 過期器械 | 1     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 10.12                      |            |
| 10月19日 (星期日) | 包裝破損 | 1     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 10-16 |
|              | 過期器械 | 3     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 11-16                      |            |
| 11月14日 (星期日) | 包裝破損 | 1     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 11.14 |
|              | 過期器械 | 1     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 12.14                      |            |
| 12月12日 (星期日) | 包裝破損 | 1     | REF 1250 Type 4 STEAM 121-134°C (250-273°F)                  | 操作者 林                           | 滅菌日期 12-12 |
|              | 過期器械 | 1     | Line turns as dark or darker than color match when processed | 有效迄日 01-12                      |            |
| 月 日 (星期 )    | 包裝破損 |       | 化學指示劑黏貼處   | <input type="checkbox"/> 是 操作者  | 滅菌日期       |
|              | 過期器械 |       |  | <input type="checkbox"/> 否 有效迄日 |            |
| 月 日 (星期 )    | 包裝破損 |       | 化學指示劑黏貼處   | <input type="checkbox"/> 是 操作者  | 滅菌日期       |
|              | 過期器械 |       |  | <input type="checkbox"/> 否 有效迄日 |            |

## B.軟體方面

項目


評分標準

10.感染管制流程制訂

C.診所須依牙科感染管制SOP，針對自家診所狀況，制訂看診前後感染管制流程、器械滅菌消毒流程及紀錄表。

檔案：表格(上限1張)

編號：B10C1

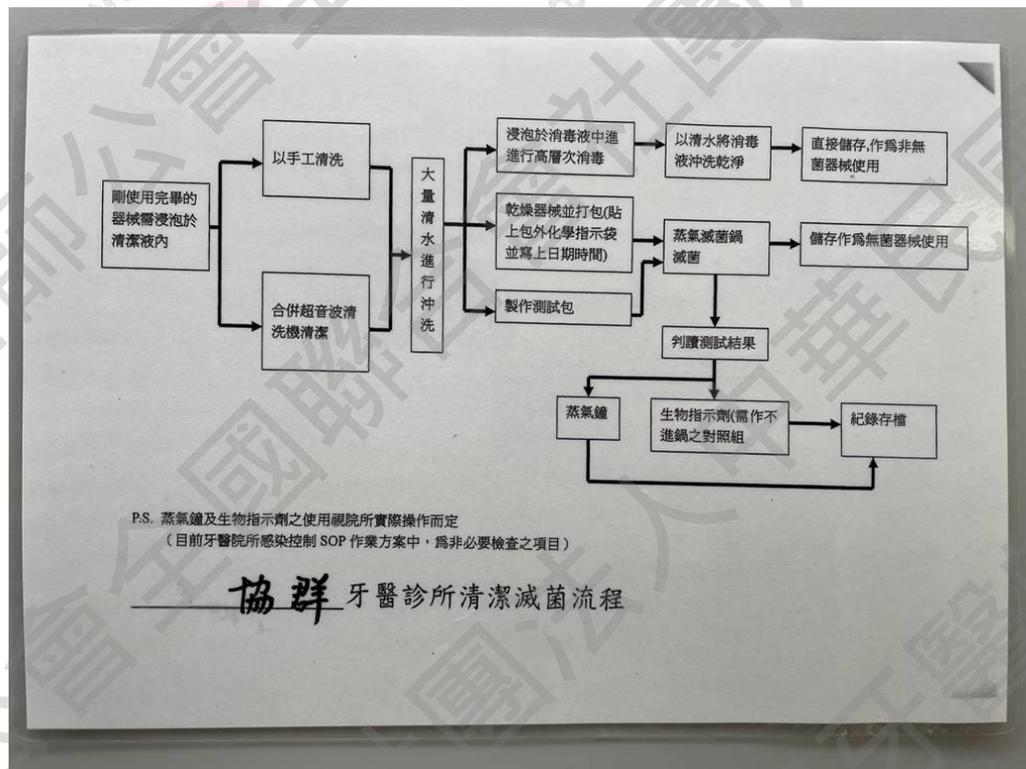

# B.軟體方面

項目


評分標準

10.感染管制流程制訂 B.符合C，診所定期全員宣導及遵循，並有完備紀錄存檔。


檔案：照片或會議紀錄(上限2張)

編號：B10B1、B10B2

編號：B10B1

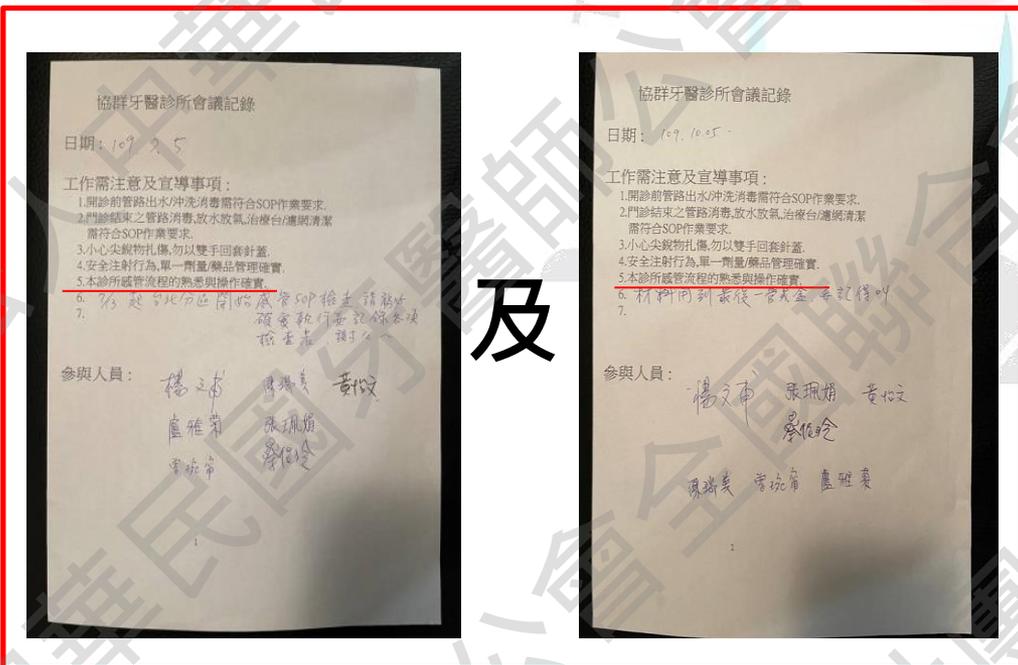

及 或

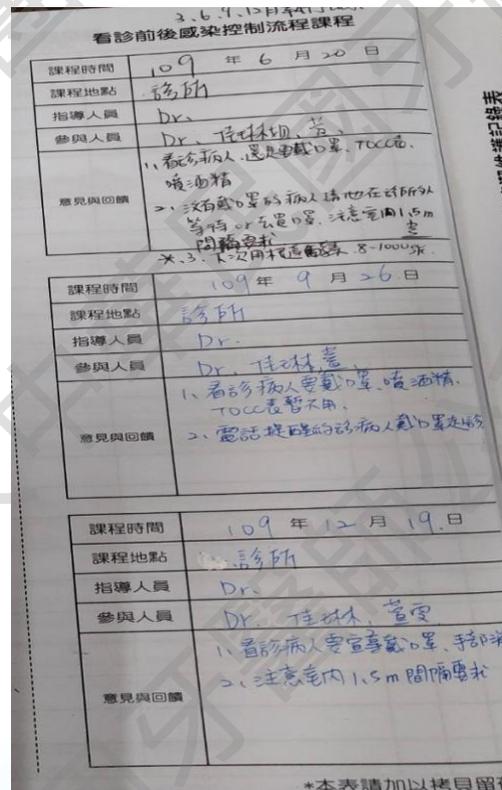

\*本表請加以拷貝留存

# B.軟體方面

項目

評分標準

10.感染管制流程制訂

A.符合B，院所內70%工作人員，每年參加一小時感管教育訓練課程，建立手部衛生教育訓練，得包括線上數位學習課程，並造冊存查。

檔案：表格或記錄(上限2張)

編號：B10A1

編號：B10A2

道德牙醫診所

| 編號 | 員工姓名 | 職稱 | 感控課程 | 日期     | 授課單位      |
|----|------|----|------|--------|-----------|
| 1  | 賴道德  | 醫師 | yes  | 109/08 | 牙醫師公會     |
| 2  | 馬久   | 醫師 |      |        |           |
| 3  | 鄧大平  | 醫師 | yes  | 109/03 | 牙全聯會      |
| 4  | 蔡佳恩  | 助理 | yes  | 109/08 | 牙醫師公會     |
| 5  | 陳亞雯  | 助理 | yes  | 109/08 | 牙醫師公會     |
| 6  | 張惠妹  | 助理 |      |        |           |
| 7  | 王淨文  | 助理 | yes  | 109/01 | 阿達廠商牙助班   |
| 8  | 李梅   | 助理 | yes  | 109/07 | 簡泰廠商至本院授課 |
| 9  | 莊熟   | 助理 | yes  | 109/07 | 簡泰廠商至本院授課 |
| 10 |      |    |      |        |           |
| 11 |      |    |      |        |           |
| 12 |      |    |      |        |           |
| 13 |      |    |      |        |           |
| 14 |      |    |      |        |           |
| 15 |      |    |      |        |           |
| 16 |      |    |      |        |           |
| 17 |      |    |      |        |           |
| 18 |      |    |      |        |           |
| 19 |      |    |      |        |           |
| 20 |      |    |      |        |           |
| 21 |      |    |      |        |           |
| 22 |      |    |      |        |           |
| 23 |      |    |      |        |           |
| 24 |      |    |      |        |           |
| 25 |      |    |      |        |           |
| 26 |      |    |      |        |           |

員工SOP課程總表

及



或



## B.軟體方面

| 項目        | 評分標準  |
|-----------|---|
| 11.安全注射行為 | C.單一劑量或單次使用包裝的注射藥品僅限單一病人單次使用(如:沒打完之麻藥管不可供他人使用)。 |

檔案：照片(上限1張)

編號：B11C1




# B.軟體方面

項目 評分標準

11.安全注射行為 B.符合C，院所定期全員宣導及遵循，並有完備紀錄存檔。

檔案：照片或會議紀錄(上限2張)

編號：B11B1、B11B2

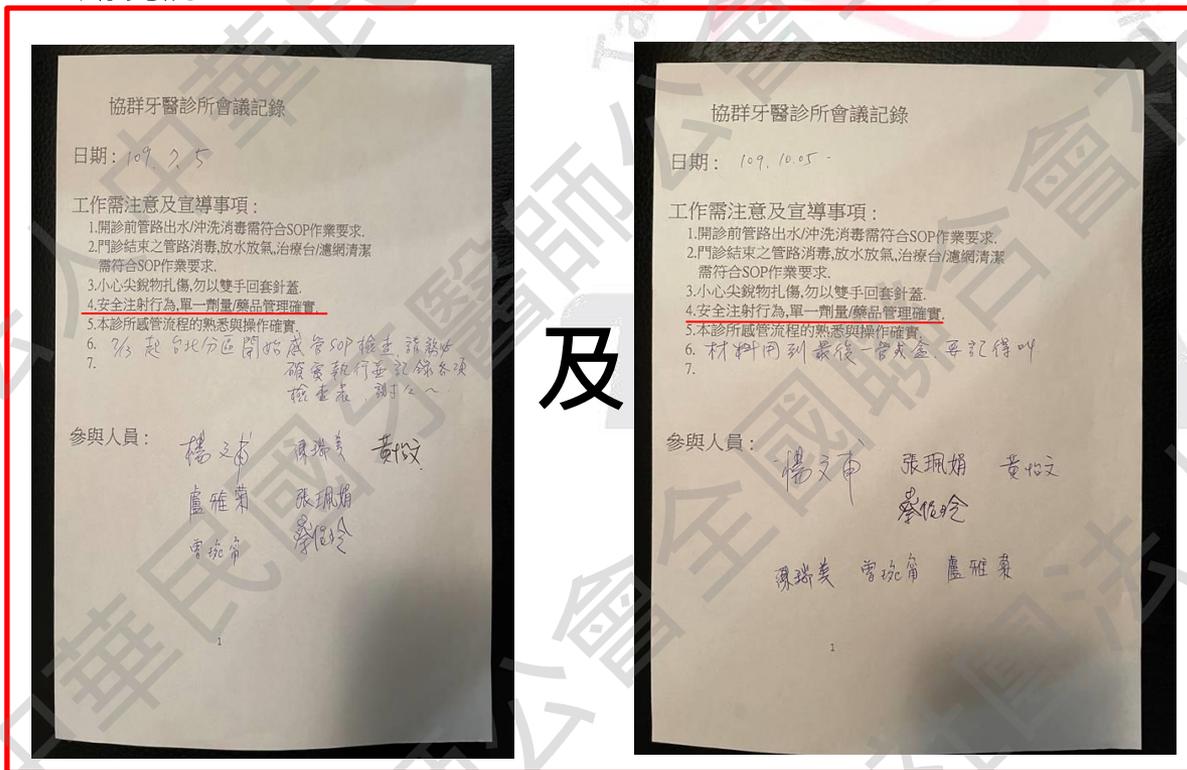

| 6月、10月自行會議紀錄<br>防範針扎及意外針扎處理流程課程 |   |
|---------------------------------|---|
| 課程時間                            | 109年6月20日   |
| 課程地點                            | 診所  |
| 指導人員                            | Dr.   |
| 參與人員                            | Dr. 佳琳、萱  |
| 意見與回饋                           | 109.1-6月無針扎。<br>1. 宣導針扎緊急處理流程。<br>2. 沒有用完的麻藥丟棄<br>要丟棄     |
| 課程時間                            | 109年9月26日   |
| 課程地點                            | 診所  |
| 指導人員                            | Dr.   |
| 參與人員                            | Dr. 佳琳、萱  |
| 意見與回饋                           | 109.6-9月無針扎。<br>1. 宣導針扎緊急處理流程。<br>2. 沒有用完的麻藥丟棄<br>丟棄物小藍桶。 |
| 課程時間                            | 109年12月19日  |
| 課程地點                            | 診所  |
| 指導人員                            | Dr.   |
| 參與人員                            | Dr. 佳琳、萱  |
| 意見與回饋                           | 109.9月-12月無發生針扎。<br>1. 宣導防範針扎及緊急處理流程。<br>2. 藍桶7分滿就要倒掉。    |

## B.軟體方面

項目

評分標準

11.安全注射行為

A.符合B，定期檢討及改善，並有紀錄可查。

檔案：表格或會議紀錄(上限2張)

編號：B11A1、B11A2



及

| 6月、12月新法行會會議紀錄<br>防範針扎及意外針扎處理流程課程 |   |
|-----------------------------------|---|
| 課程時間                              | 109年6月20日   |
| 課程地點                              | 診所  |
| 指導人員                              | Dr.   |
| 參與人員                              | Dr. 佳琳、管  |
| 意見與回饋                             | 109.1-6月無針扎。<br>1. 宣導針扎緊急處理流程。<br>2. 沒有用完的麻藥丟棄至藥桶     |
| 課程時間                              | 109年9月26日   |
| 課程地點                              | 診所  |
| 指導人員                              | Dr.   |
| 參與人員                              | Dr. 佳琳、管  |
| 意見與回饋                             | 109.6-9月無針扎。<br>1. 宣導針扎緊急處理流程。<br>2. 沒有用完的麻藥丟棄至藥桶     |
| 課程時間                              | 109年12月19日  |
| 課程地點                              | 診所  |
| 指導人員                              | Dr.   |
| 參與人員                              | Dr. 佳琳、管  |
| 意見與回饋                             | 109.9月-12月無發生針扎。<br>1. 宣導防範針扎及緊急處理流程。<br>2. 藥桶滿了就要換掉。 |

## B.軟體方面

項目

評分標準

12.一人一機

C.高速手機清洗並以滅菌袋包裝後，進鍋滅菌並標示滅菌日期。

檔案：照片(上限2張)

編號：B12C1

提醒：

呈現至少4支手機打包狀態



## B.軟體方面

項目

評分標準

12.一人一機

B.符合C，放置包內包外化學指示劑監測，並完整紀錄。

檔案：照片及表格(上限2張)

編號：B12B1、B12B2



及

| 【開水更換】 |        | 1/28   |      | 生物指示劑結果 |    | 實驗組           |          | 執行者  |     | 檢核者 |    |
|--------|--------|--------|------|---------|----|---------------|----------|------|-----|-----|----|
| 處理時段   | 溫度(°C) | 超量度(%) | 清水沖洗 | 漂乾      | 打卷 | 溫度            | 壓力       | 時間   | 執行者 | 檢核者 | 備註 |
| 12月 早  | 121    | ✓      | ✓    | ✓       | ✓  | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 12月 中  | 121    | ✓      | ✓    | ✓       | ✓  | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 12月 晚  | 121    | ✓      | ✓    | ✓       | ✓  | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 12月 早  | 121    | ✓      | ✓    | ✓       | ✓  | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 12月 中  | 121    | ✓      | ✓    | ✓       | ✓  | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 12月 晚  | 121    | ✓      | ✓    | ✓       | ✓  | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 一月 早   | 121    |        |      |         |    | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 一月 中   | 121    |        |      |         |    | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |
| 一月 晚   | 121    |        |      |         |    | 121°C / 15min | 1.05 bar | 3min |     |     |    |

## B.軟體方面

項目

評分標準

12.一人一機

A.符合B，每週至少一次生物指示劑監測及消毒鍋檢測，並完整紀錄。


檔案：照片及表格(上限2張)

編號：B12A1、B12A2


可與B08A1、B08A2相同



及

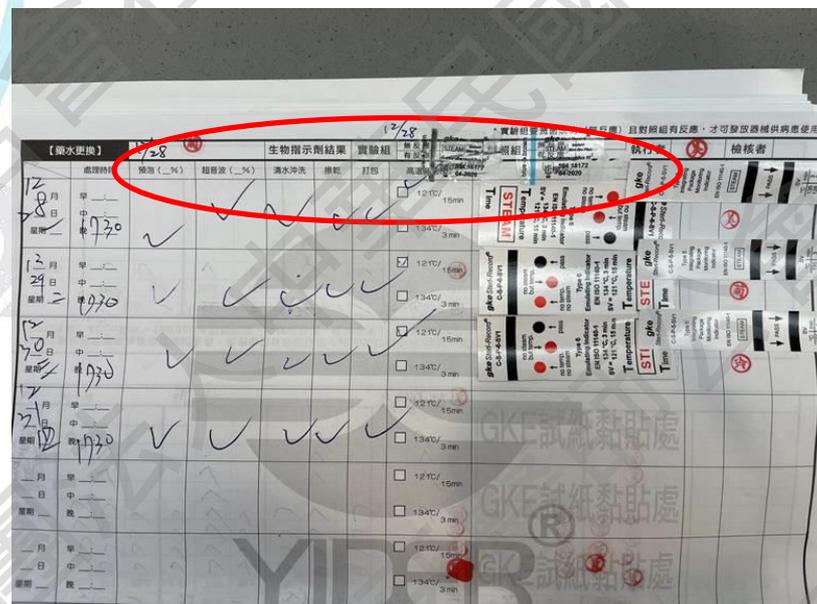

# 全面訪查架構

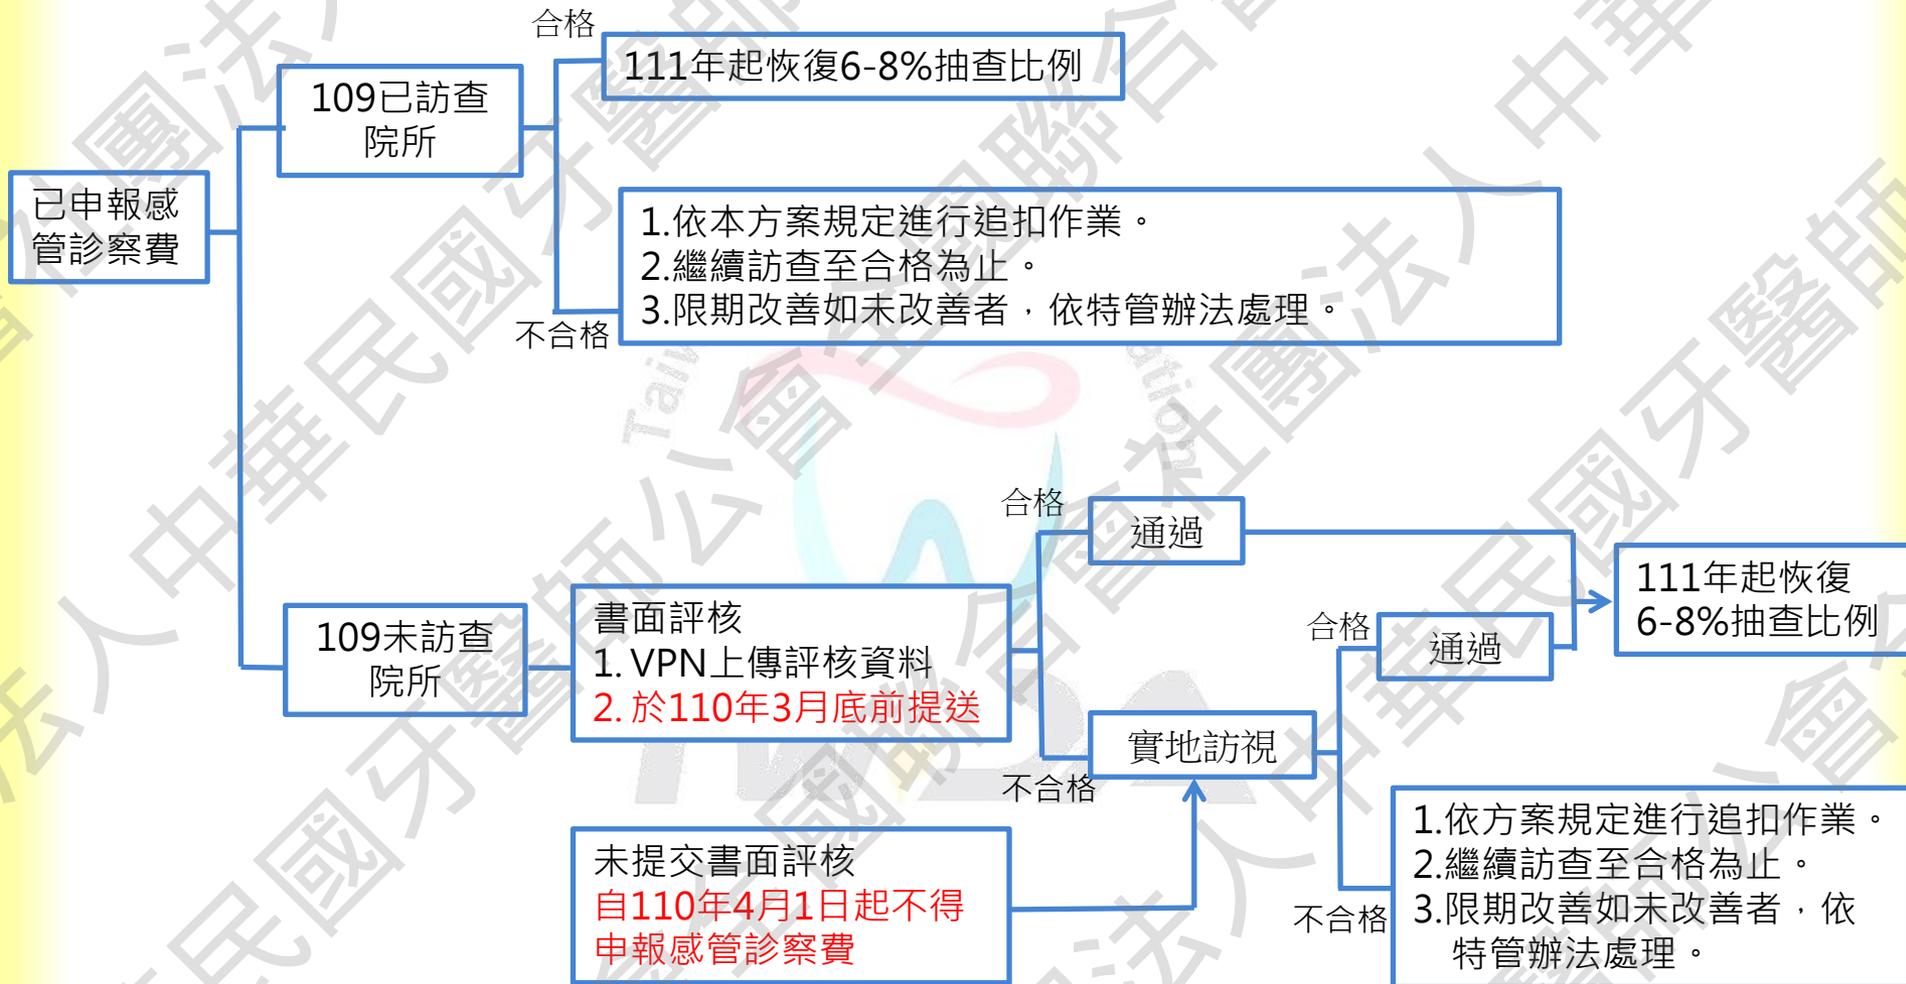

# 評核機制

1. 如照片模糊、錯置，以致審查醫師無法審查，及內容尚可改善者，可補件1次。
2. 審查醫師評核認定內容尚可改善者補件需於7日內重新上傳(不含例假日)。



# 感管懶人包-1

>110年完成VPN上傳SOP評核資料

>110年免6%-8%院所抽訪!

全面評核

- 3月底前以VPN上傳SOP評核資料
- 109年曾實地訪視合格之院所→除外

VPN  
評核不合格

- 6月底前實地訪查

實訪不合格

- 停止申報SOP診察費
- 核扣SOP與一般診察費差額
- 持續複查至合格

# 感管懶人包-2

110年7月起，感管診察費=唯一診察費！

全體院所均需  
符合加強感染  
管制實施方案

110.7.1起  
**取消**  
一般診察費

拒絕公會輔導、  
屢次無法改善者：  
健保署將以特管辦法  
記點、恐無法續約  
甚至健保停約

# 感管懶人包-3

## 考評內容相同

110年SOP考評內容  
是不是變難了?

110年考評內容與  
109考評內容**相同**

只是需VPN上傳  
評核資料


拍攝符合評核要求的  
照片再上傳就OK



# 感管懶人包-4

## 留意各分區審查分會、各縣市公會宣導訊息

- 本範例已提供給六區審查分會
- 除了自行閱讀範例說明外，也請留意各分區各縣市公會的宣導訊息。

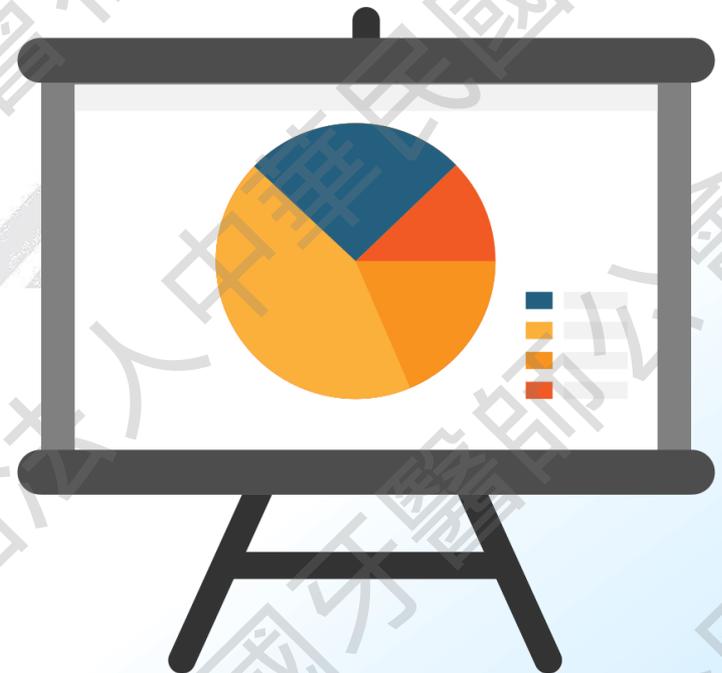



簡報製作、圖片提供：楊文甫、曾士哲醫師

意見修訂：吳迪醫師

版權所有：社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

**授權非營利的轉載利用，請保留完整授權資訊，禁止刪改內容**

(修訂內容尚依健保署公告為準)